



กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ฐานที่
အဆင့်

3




การใช้อุปกรณ์วัดออกซิเจนปลายนิ้ว และอุปกรณ์วัดไข้

အောက်စီမီတာအသုံးပြုခြင်းနှင့် ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာအသုံးပြုနည်း



กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์วัดออกซิเจนปลายนิ้ว

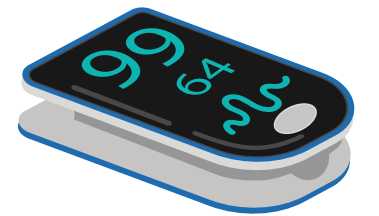

આવકોઈમિત્ર અડખું:પ્રપૂંઅဆડુંဆડું



1.

ล้างมือให้สะอาด

ลดการติดเชื้อจากมือ



2.

นำเครื่องไว้ที่นิ้วชี้หรือนิ้วกลาง



လက်ညှိုး(သို့) လက်ခလယ်ထိပ်တွင် အောက်စီမီတာအားထားရှိပါ



3.

ກດປຸ່ມສີຂາວ

ອຸປະກອນ ວລຸດໜ້າຮູ້ບໍ່ປົາ



กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง



4.

ရဝဏ်းရောင်ပြသမှု



စက်မှ ရလဒ်ထွက်သည်ထိ စောင့်ပါ



5.

အ่านမလ

ရလဒ်ဖတ်ခြင်း




သံအကစီအေ | အောက်စီဂျင်

တံအကစီ 95 သီ အမပကတိ
အောက်ဖြစ်ပက ပံမုန်မဟုတ်ပါ

ဖီဖအ | သွေးဝန်နှုန်း

တံအကစီ 60 ငြိး/နာတီ
1မိနုတ်/ အကြိမ် 60 အောက် (သို) ဟီ
—
ဖွဲကစီ 100 ငြိး/နာတီ အမပကတိ
1မိနုတ်/100 အထက်ဖြစ်ပက
ပံမုန်မဟုတ်ပါ



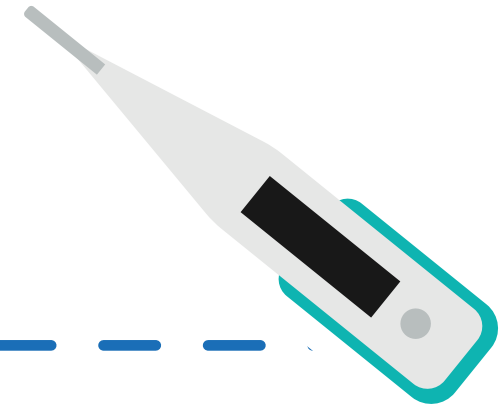

ขั้นตอนการใช้อุปกรณ์วัดไข้

กុ้ย๋အပူချိန်တိုင်းတာသည့်ကိရိယာ အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့်



1.

ล้างมือให้สะอาด

ลดการติดเชื้อจากมือ



2.

ใช้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์



กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

— — — — —
အရက်ပျံ့ဖြင့် သန့်ရှင်းအောင် သုတ်ပေးပါ



3.

กดปุ่มเพื่อเปิดเครื่อง

อลูมิเนียม



4.

รอกจนขึ้นคำว่า Lo

Lo เหวี่ยงจู้จู้จู้จู้



5.

นำส่วนปลายของปรอทเลียบใต้รักแร้
และรอจนได้ยินเสียงเตือน

ကိုဦးကြားအတွင်းသို့ သာမိုမီတာအဖျားအား ထည့်သွင်းပြီး အချက်ပြအသံပေးသည့်ထိစောင့်ပါ



นำส่วนปลายของปรอทเลียบใต้รักแร้



6.

อ่านผล


อุณหภูมิร่างกาย

ปกติ : อุณหภูมิร่างกาย

😊 ปกติ $35.4 - 37.4$

➤

😞 มีไข้ ≥ 37.5

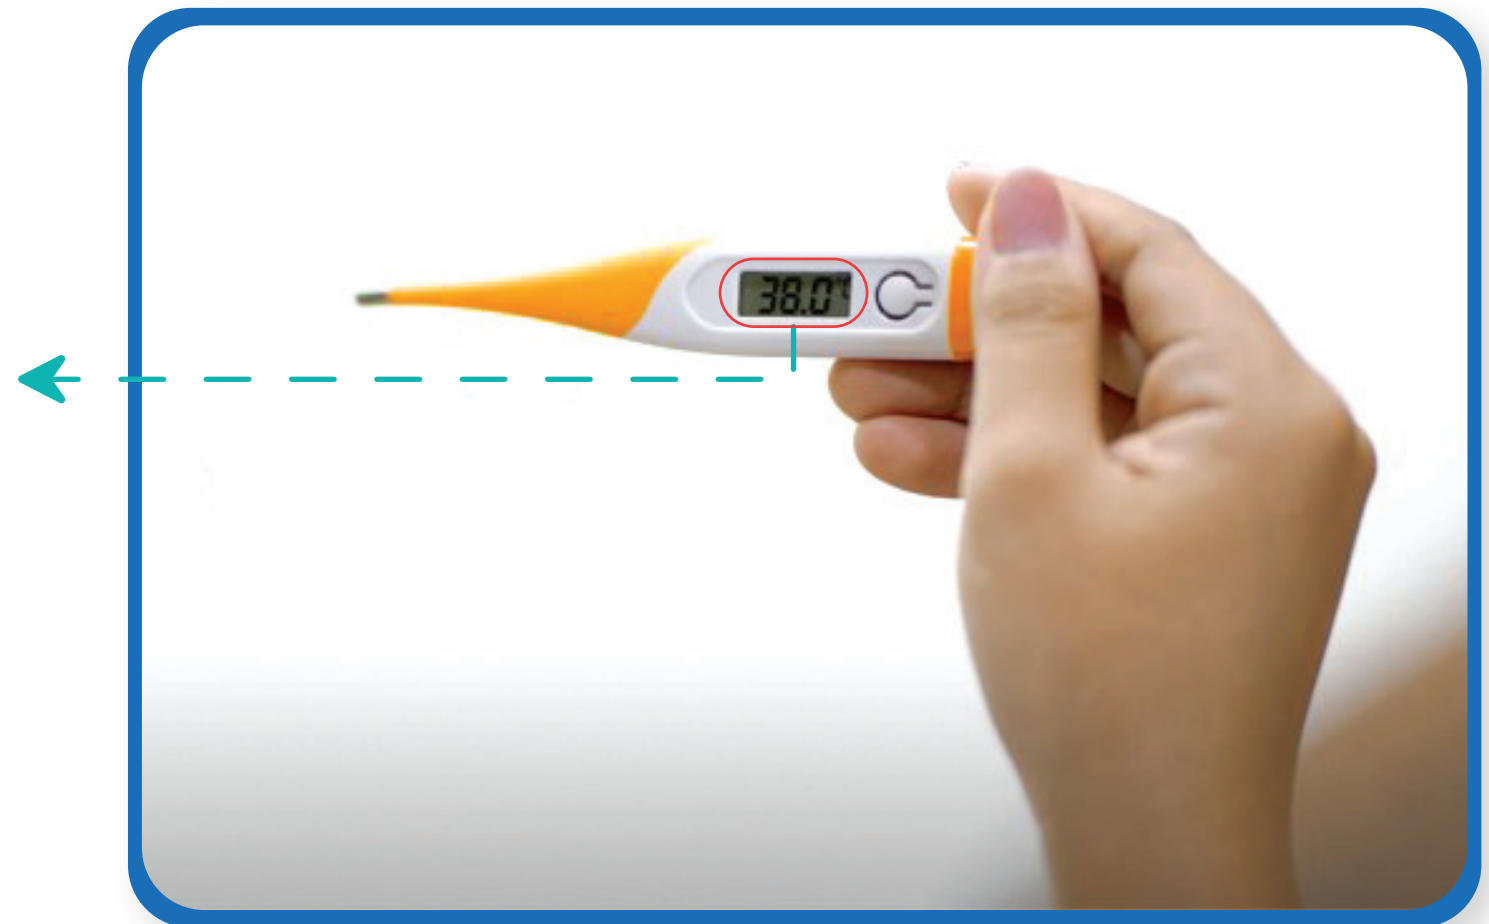

7.

ใช้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์



กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

— — — — —
အရက်ပျံ့ဖြင့် သန့်ရှင်းအောင် သုတ်ပေးပါ





เก็บให้เรียบร้อย



กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อย

